


Marqueurs

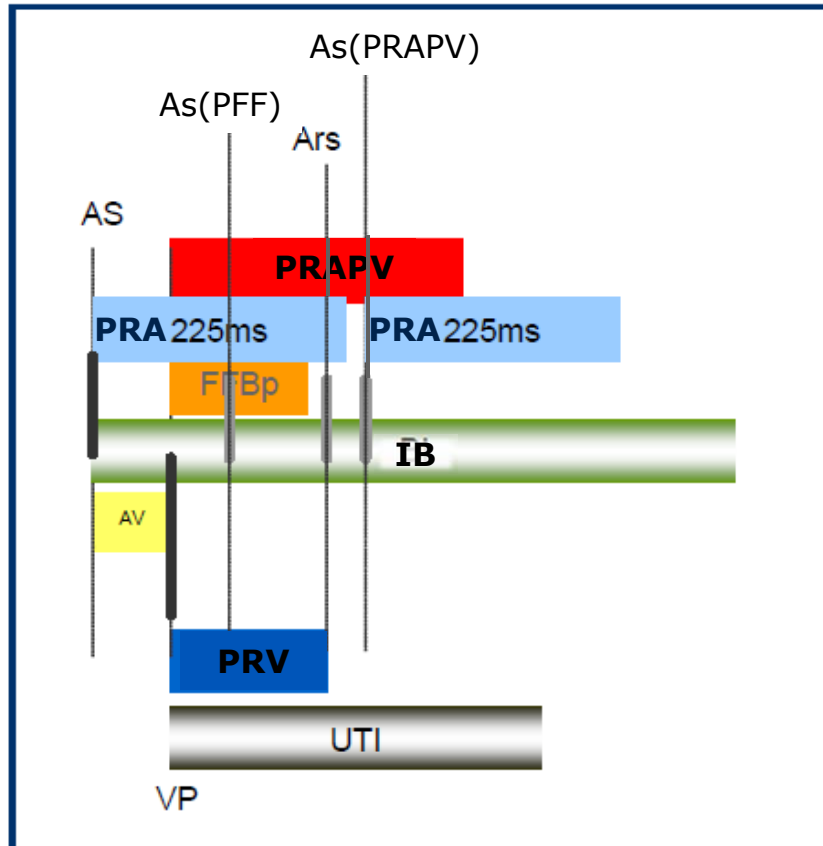

PRAPV : Période Réfractaire Atriale Post Vent.

PRA : Période Réfractaire Atriale

FFBp : Blanking Farfield après Vp

PRV : Période Réfractaire Ventriculaire

UTI : Upper Tracking Interval

Marqueurs atriaux

As	Événement atrial détecté
Ap	Événement atrial électro-entraîné
Ars	Événement atrial détecté en période réfractaire atriale (PRA)
Ars (PFF)	Événement atrial détecté en Protection FarField
As (PRAPV)	Événement atrial détecté en Période Réfractaire Atriale Post Ventriculaire

Marqueurs ventriculaires

Vs	Événement ventriculaire détecté
Vp	Événement ventriculaire électro-entraîné
VGp/VGs	Événement ventriculaire gauche détecté ou électro-entraîné
ESV	Extrasystole ventriculaire
Vrs	Événement ventriculaire détecté en période réfractaire ventriculaire (PRV)

Marqueurs

Marqueurs Brady	
As	Evènement atrial détecté
Ap	Evènement atrial électro-entraîné
Ars	Evènement atrial détecté en période réfractaire atriale (PRA)
As (PRAPV)	Evènement atrial détecté en Période Réfractaire Atriale Post Ventriculaire
Vs	Evènement ventriculaire détecté
Vp	Evènement ventriculaire électro-entraîné
VGs/VGp	Evènement ventriculaire gauche détecté ou électro-entraîné
ESV	Extrasystole ventriculaire
Marqueurs Tachy	
Vs	Détection ventriculaire en zone sinusale
TV1	Détection ventriculaire classifiée en zone de TV1
TV2	Détection ventriculaire classifiée en zone de TV2
FV	Détection ventriculaire classifiée en zone de FV
AFlut	Evènement classé en TSV, SMART branche n°2 Flutter Atrial
Afib	Evènement classé en TSV, SMART branche n°4 Fibrillation Atriale
SinT	Evènement classé en TSV, SMART branche n°8 Tachy Sinusale
1 :1	Evènement classé en TSV, SMART branche n°10 Tachy Sinusale instable
TA	Evènement auriculaire classifié en tachy atriale
Dét FV	Fibrillation Ventriculaire détectée
Dét TV	Tachycardie Ventriculaire détectée
Dét TSV	Tachycardie Supra Ventriculaire détectée
Début	Critère de discrimination « début soudain » rempli
Rdt	Re-détection
ATP Rafale	Stimulation Anti-tachycardique en Rafale
ATP Rampe	Stimulation Anti-tachycardique en Rampe
ATP One Shot	ATP durant la charge des condensateurs
—	Charge des condensateurs
Post Sh	Comportement Post choc